


Feb 09, 2020

Version 3

MICRO-DILUCIÓN EN PLACA PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA EN 50 uL V.3

DOI

[dx.doi.org/10.17504/protocols.io.8xmhxk6](https://doi.org/10.17504/protocols.io.8xmhxk6)



Germán Alberto Téllez Ramírez¹, Lily Johanna Toro², Juliana Franco Castrillon³, Diana Carolina Henao¹, Jhon Carlos Castaño Osorio³, Grupo De Inmunología Molecular GYMOL Universidad Del Quindío³

¹Centro de Investigaciones Biomédicas; ²Centro de Investigaciones Biomédicas - Universidad del Quindío;

³Centro de Investigaciones Biomédicas - Universidad del Quindío - Colombia



Grupo De Inmunología Molecular GYMOL Universidad Del Quindío

Centro de Investigaciones Biomédicas - Universidad del Quind...

Create & collaborate more with a free account

Edit and publish protocols, collaborate in communities, share insights through comments, and track progress with run records.

[Create free account](#)

OPEN  ACCESS



DOI: <https://doi.org/10.17504/protocols.io.8xmhxk6>

Protocol Citation: Germán Alberto Téllez Ramírez, Lily Johanna Toro, Juliana Franco Castrillon, Diana Carolina Henao, Jhon Carlos Castaño Osorio, Grupo De Inmunología Molecular GYMOL Universidad Del Quindío 2020. MICRO-DILUCIÓN EN PLACA PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA EN 50 μ L . **protocols.io**

<https://dx.doi.org/10.17504/protocols.io.8xmhxk6>

Manuscript citation:

- O'Brien J, Wilson I, Orton T, Pognan F. 2000. Investigation of the Alamar Blue (resazurin) fluorescent dye for the assessment of mammalian cell cytotoxicity. *Eur J Biochem*. 2000 Sep; 267(17):5421-6. Technical Bulletin. CellTiter-Blue® Cell Viability Assay. Promega. INSTRUCTIONS FOR USE OF PRODUCTS G8080, G8081 AND G8082.
- Wiegand I, Hilpert K, Hancock RE. Agar and broth dilution methods to determine the minimal inhibitory concentration (MIC) of antimicrobial substances. 2007. *Nat Protoc*. 2008;3(2):163-75. doi: 10.1038/nprot.2007.521.
-

License: This is an open access protocol distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution License](#), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited

Protocol status: Working

We use this protocol and it's working

Created: November 01, 2019

Last Modified: February 09, 2020

Protocol Integer ID: 29389

Keywords: antimicrobial, peptides, compounds, fluorescence, antibiotics in laboratory medicine, susceptibility testing of antimicrobial, la actividad antibacteriana, antibiotic, national committee of laboratory safety, laboratory safety, laboratory medicine, laboratory

Abstract

Este método es basado en el método clásico de micro-dilución en placa de NCCLS (National Committee of Laboratory Safety and Standards (NCCLS) como fue publicado en Amsterdam, D. 1996. Susceptibility testing of Antimicrobials in liquid media. In 'Antibiotics in Laboratory Medicine', Lorian, V., ed. Fourth Edition, pp.52-111. Williams and Wilkins, Baltimore.

Modificado con respecto a la lectura de la placa utilizando un indicador metabólico para incrementar la sensibilidad de la prueba respecto al crecimiento de las bacterias.

La realización de este protocolo fue posible gracias al apoyo del departamento administrativo de ciencia tecnología e innovación, Colciencias a través del proyecto 111356933173 convocatoria569-2012.

Este protocolo fue estandarizado con el desarrollo del proyecto de grado "OPTIMIZACIÓN DE UN MÉTODO PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA IN VITRO EN MICROVOLÚMENES" de la estudiante Juliana Franco para optar por el título de Bióloga.

Guidelines

El siguiente procedimiento consta del crecimiento de las bacterias, preparacion de la muestra, dilucion de las bacterias, incubacion lectura y analisis.

Tiempo estimado 3 días contando la descongelación de las bacterias.

La lectura se puede realizar por turbidez, Absorbancia libre o con resazurin; o fluorescencia de resorufin.

Materials

MATERIALS

 **resazurin** **Acros Organics Catalog # 189900050**

 **96-well microtiter plates polypropilene** **greiner bio-one Catalog #650201**

 **Mueller Hinton** **scharlau Catalog #02-136**

Troubleshooting

Safety warnings

-  Maneje todas las normas de bioseguridad microbiológica dependiendo de la muestra y la bacteria a utilizar (cepas de referencia, aislados clínicos, patogénicos).

Before start

Medio de cultivo Muller Hinton líquido (15mL por placa aprox)

Medio de cultivo Mueller Hinton Agar (1 plato por bacteria a evaluar)

Resazurin 440 μ M (10X): tome 0.011g de resazurin y lleve a 100mL en agua destilada, mezcle en frasco ámbar, filtre por 0.22 μ m y guarde oculto de la luz 4°C. (absorbancia máxima resazurin=603nm; absorbancia máxima resorufin=570nm) (excitación 579/Emisión 584)

Antibiótico como control positivo. (Antibiótico antimicótico de cultivo celular 100X= penicilina 10000 unidades/ml streptomicina 10000unidades /mL)

Muestras péptido a evaluar para compuestos puros generalmente se trabajan desde concentraciones finales de 100 μ g/mL.

Preparación de las bacterias

- 1 Tome las bacterias a evaluar del banco de células y siga el protocolo de descongelación (siembre en placas de medio selectivo e incube a 37°C por 12-24 horas)

Inocule una de las colonias de las bacterias a evaluar en tubos conicos de 15ml con de 2-5ml de caldo de cultivo Muller Hinton y lleve a 37°C en agitación a 180 rpm deje crecer por 5-8 horas aprox.

 12:00:00 incuba bacterias

 05:00:00 crecimiento inóculo

Preparación de la muestra

- 2 Diluya el péptido a una concentración 10 veces más alta con respecto a la concentración máxima a evaluar (solución stock del péptido).

Realice diluciones seriadas de la solución stock del péptido en agua estéril o medio de cultivo, según corresponda a las diluciones del péptido que se quieren evaluar.

Adicione 5 µL de cada una de las diluciones del péptido en cada uno de los pozos correspondientes (columnas 1-10).

Adicione 50 µL de medio Mueller Hinton a la columnan 11 como control de medio y 45 µL a las filas D y G como control de esterilidad del compuesto.

 00:40:00 por placa

Dilución de las bacterias

- 3 Tome las bacterias crecidas en el paso 1 y diluya o deje crecer hasta alcanzar una concentración aproximada de 3-6 por 10 a la 8 UFC, lo cual corresponde a una densidad óptica (O.D) de 0,2 a 0,4 a una longitud de onda de 600 nm en celda de 1 cm ó a una O.D de 0,1 a 570 nm en 100 µL en placa de ELISA de 96 pozos.

Tome las bacterias del paso anterior y diluya 1:1000 en medio líquido Muller Hinton para llevar a una concentración de 3-5 por 10 a la 5 UFC (solución de trabajo de bacterias)

Adicione 45 µL de la solución de trabajo de bacterias a todos los pozos de la placa de microtitulación menos fila D, H y columna 11 como se indica en la Tabla 1.

Tabla 1

	µg/ml		25 0	12 5	62 ,5	31, 25	15, 62	7,8 1	3, 91	1,9 5	0, 98	0, 49	C-	C+
	Replicas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Replica 1 de cada tratamient o	A												
	Replica 2 de cada tratamient o	B												
	Replica 3 de cada tratamient o	C												
	Ctrl esterilidad péptidos	D												
	Replica 1 de cada tratamient o	E												
	Replica 2 de cada tratamient o	F												
	Replica 3 de cada tratamient o	G												
	Ctrl esterilidad péptidos													

Deje incubar por 12-16 horas (crítico: no más de 16 horas) a 37°C sin agitación.

 00:30:00 adicionar bacterias

 13:00:00 incubación placa

Análisis

- 4 Para leer por turbidimetría lea la absorbancia a 570nm

- 5 Para leer por Absorbancia con resazurina: adicione 5 μ L de solución de rezasurina a 440 μ M para una concentración final de 44 μ M en cada pozo

Incube por 2 horas a 37°C

Lea las placas en espectrofotómetro a 570 y 603nm

Realizar delta: por cada pozo reste la absorbancia de 570nm menos 603 nm

Delta = A570nm-A603nm

A partir del grupo de datos del delta calcula:

Blancos: calcula la mediana del grupo de blancos C- (medio de cultivo).

Blanco = Mediana (11A:11C)

Reste el blanco a los valores del delta de cada pozo

A partir del grupo de datos del delta menos el blanco calcula:

Creminiento de bacterias: calcula la mediana del grupo de crecimiento de bacterias C+.

ControlBacterias= Mediana(12A:12C)

A partir de estos valores calcula el porcentaje de crecimiento de cada pozo haciendo una relacion directa.

%Crecimiento= (X/Control de bacterias)*100

X= Valor de delta menos el blanco de cada pozo.

- 6 Para leer por Fluorescencia

Adicione resazurina a concentración final de 44 μ M.

Deje incubar por 90 minutos

Lear la placa ext/emisión 579/584 (filtros ext 565/10; em 600/40)

Tome los valores de fluorescencia y calcula:

Blancos: calcula la mediana del grupo de blancos C- (medio de cultivo).

Blanco = Mediana (11A:11C)

Resta el valor del blanco a todos lo pozos.

Crecimiento de bacterias: calcula la mediana del grupo de crecimiento de bacterias C+.

ControlBacterias= Mediana(12A:12C)

A partir de estos valores calcula el porcentaje de crecimiento de cada pozo haciendo una relación directa.

$$\% \text{Crecimiento} = (X/\text{Control de bacterias}) * 100$$

X= Valor fluorescencia menos el blanco

7

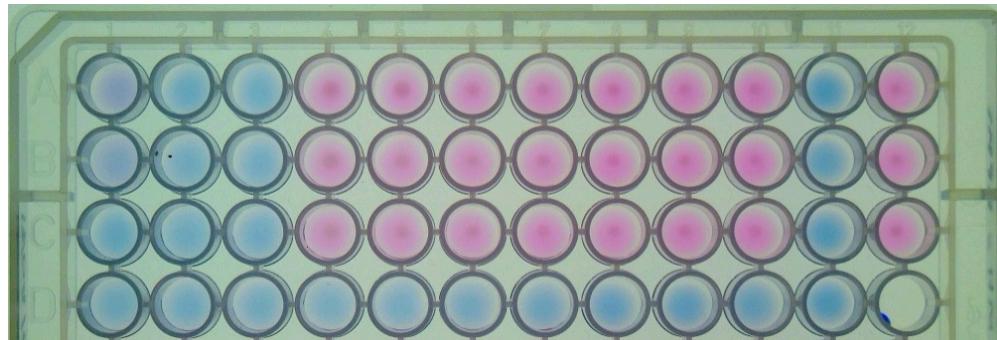


Fig 1. Microdilución en placa de 96 pozos después de 2 horas de incubación con la resazurina. Columnas 1A-1C a 10A-10C (molecula a evaluar, desde la concentración más alta (100ug/mL) hasta (0,19ug/mL). Columnas 11A-11C (control de esterilidad del medio), columnas 12A-12C (control de viabilidad bacteriana). fila D1-D12 (control de esterilidad de la molecula evaluada)

Dataset

Microdilución

NAME

[https://drive.google.com/file/d/0B6V_oEAQZQMU1VVXY2RXI5Z0U/view?
usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/0B6V_oEAQZQMU1VVXY2RXI5Z0U/view?usp=sharing)

LINK

CBM

8 Para calcular la concentración bactericida mínima (C.B.M)

Tome 10 μ L de hasta 3 concentraciones por triplicado sin crecimiento viable y siembre en platos de agar mueller Hinton.

Incube por 18 a 24 h a 37°C y cuente las colonias

La C.B.M es considerada como la concentración más baja que previene la formación de colonias residuales (fig 2)

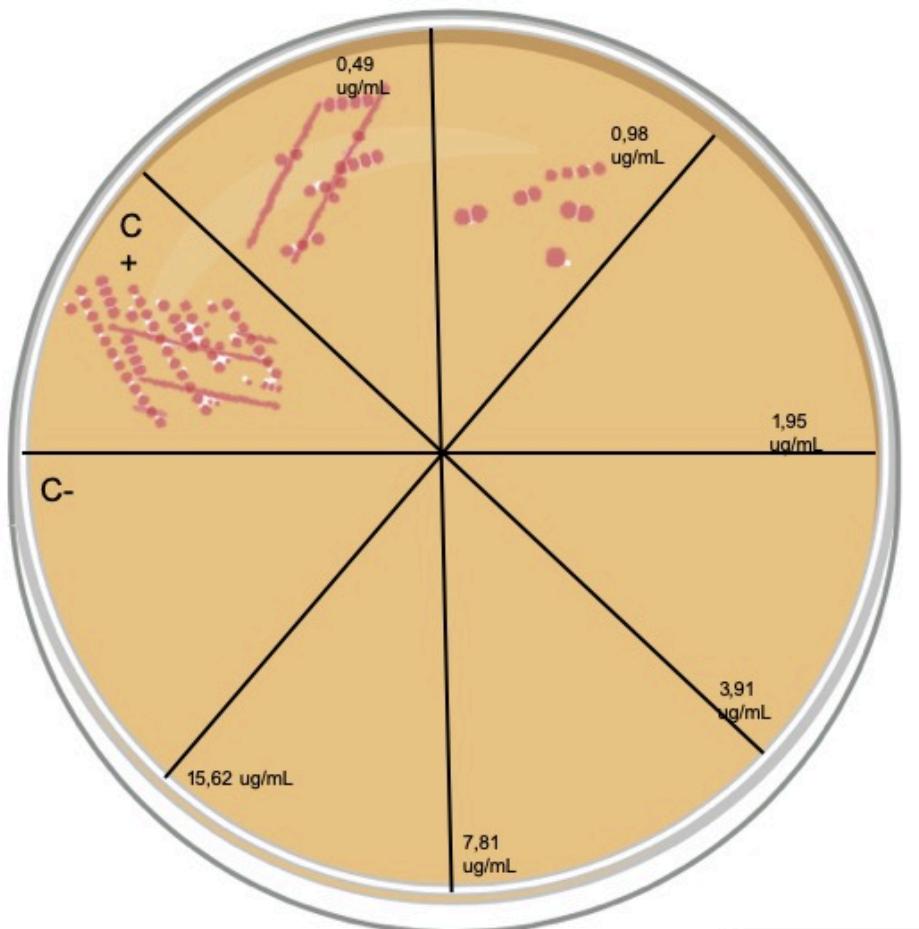


Figura 2. Caja de petri con agar Muller Hinton, en donde la concentración bactericida mínima (CMB) es 1,95 ug/mL.